

**BRAVO À TOUS !!!**

Il ne nous reste plus que **41 patients à inclure** pour atteindre l'objectif soit **10 par mois** environ d'ici la clôture prévue le 10 Avril 2017.

**N'oubliez pas d'inclure les patients quelle que soit l'option choisie : explantation ou abandon de la sonde.**

**L'analyse intermédiaire** des données permet déjà d'identifier des profils différents de patients dans les deux groupes.

Nous poursuivrons ensuite la **période de suivi de 2 ans minimum** pour chaque patient.

Comme vous le savez, les complications de l'extraction de sondes sont bien documentées contrairement à celles liées aux sondes abandonnées. C'est le suivi à deux ans qui nous permettra, j'espère, de les mettre en évidence et qui fera l'originalité de ce registre.

Merci à tous pour votre implication dans ce registre et bonne fin d'année.


Dr Christine ALONSO – Investigateur principal

Le Dr Christine Alonso a mis en place l'observatoire FRAGILE, dont la Société Française de Cardiologie est le Promoteur.

L'étude a été mise en place le 10 avril 2013.

**La période d'inclusions est ouverte jusqu'au 10/04/2017.**

#### POINT INCLUSIONS : 459 patients au 08/12/2016

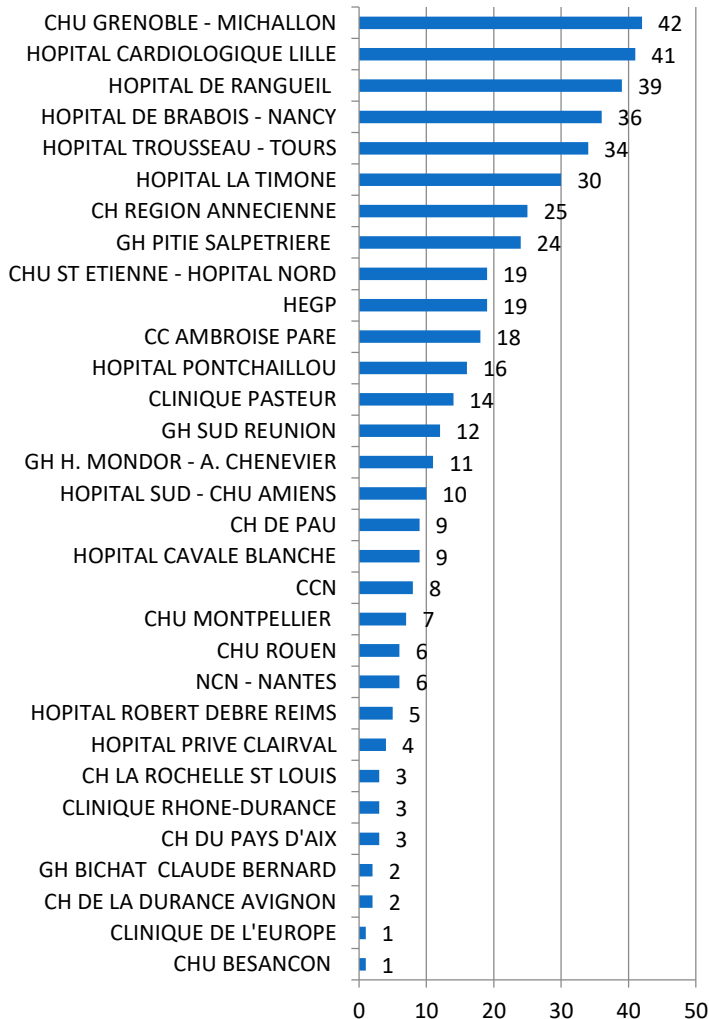

#### NOUVELLE BASE : <http://fragile-sfc.eu>

Récemment, un changement de base a eu lieu récemment, ce qui entraîne quelques modifications dans son utilisation. Parmi elles :

- L'obligation de **signer les différentes pages**
- **L'indication du nombre de tâches à effectuer** (Formulaire à compléter et/ou à signer) :
  1. Des vignettes chiffrées vous indiquent le nombre de formulaires incomplets ou non signés.
  2. Vous recevrez mensuellement un bilan de saisie de votre centre.

Un **guide de saisie** est disponible dans l'onglet « documents » de la base de données.

#### RAPPELS CRITERES D'INCLUSION

- Tout patient devant bénéficier d'un remplacement de sonde de défibrillation non motivé par une infection et ayant été informé.
- Patient ayant accepté de participer à l'étude.
- Patients âgés de 18 ans et plus.

#### OBJECTIF DU REGISTRE

L'observatoire FRAGILE a pour but de recueillir l'attitude des différents centres et des différents opérateurs lors du remplacement d'une sonde de défibrillation défectueuse ou "à risque".

